MIDMARK®

Montage-/ Bedienungsanleitung

DREHGELENK-ARMABLAGE TEILNR. 9A81001/003 oder 9A176002

TEILE IM KIT

Teilnr.	Beschreibung	Menge
9A81001/003	Drehbare Armablage	1
oder		
9A176002	Drehbare Armablage	1
003-0373-01	Montage-/Bedienungsanleitung	1

ERFORDERLICHE WERKZEUGE

3 mm Innensechskantschlüssel

EINFÜHRUNG

Zum Halten eines Arms in einer sicheren Position. Die Armablage 9A81001/003 ist an medizinischen Untersuchungstischen angebracht. Die Armablage 9A176002 kann an bestimmten Fahrtragen und Operationstischen montiert werden.

WARNUNG

Die Armablage an der Seitenschiene des Untersuchungstisches bzw. der Fahrtrage anbringen. Bei der Positionierung der Armablage bzw. des Tisches vorsichtig vorgehen. Dieses Zubehörteil nicht mit anderem Zubehör auf der gleichen Tischseite verwenden. Wenn die Armablage bei *heruntergeklappter* Seitenschiene verwendet wird, sicherstellen, daß der Patient sicher angegurtet ist, um ein versehentliches Herunterfallen auszuschließen. Die Armablage stets abstützen, während sie verstellt wird. Stets sicherstellen, daß die gewählte Stellung sicher eingerastet ist, um plötzliche Bewegungen während des Verfahrens zu vermeiden.

MONTAGE

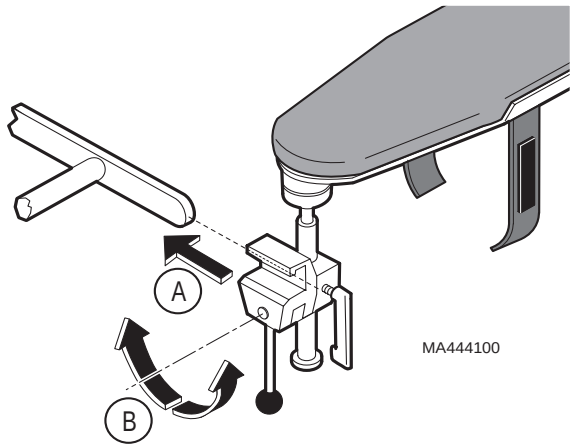

A. Den Drehsockel in die gewünschte Stellung an der Seitenschiene schieben.

B. Den Verriegelungsgriff auf eine Seite drehen, um den Drehsockel an der Seitenschiene zu verriegeln.

BEDIENUNG (DREHUNG)

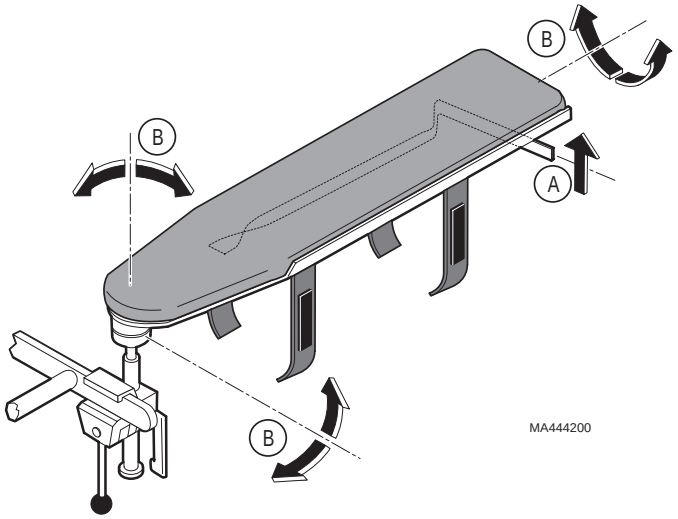

A. Die Armablage abstützen und am Griff nach oben ziehen.

B. Die Armablage in die gewünschte Position drehen und den Griff loslassen.

© Midmark Corporation - 1998

BEDIENUNG
(HÖHENVERSTELLUNG)

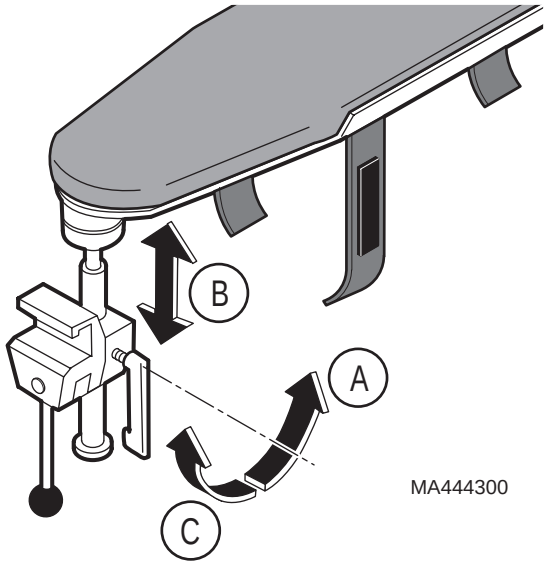

A. Die Armablage abstützen und den Klemmgriff lösen.
B. Die Armablage in die gewünschte Stellung anheben bzw. absenken.
C. Den Klemmgriff anziehen.

© Midmark Corporation - 1998

EINSTELLUNG
(VERRIEGELUNG)

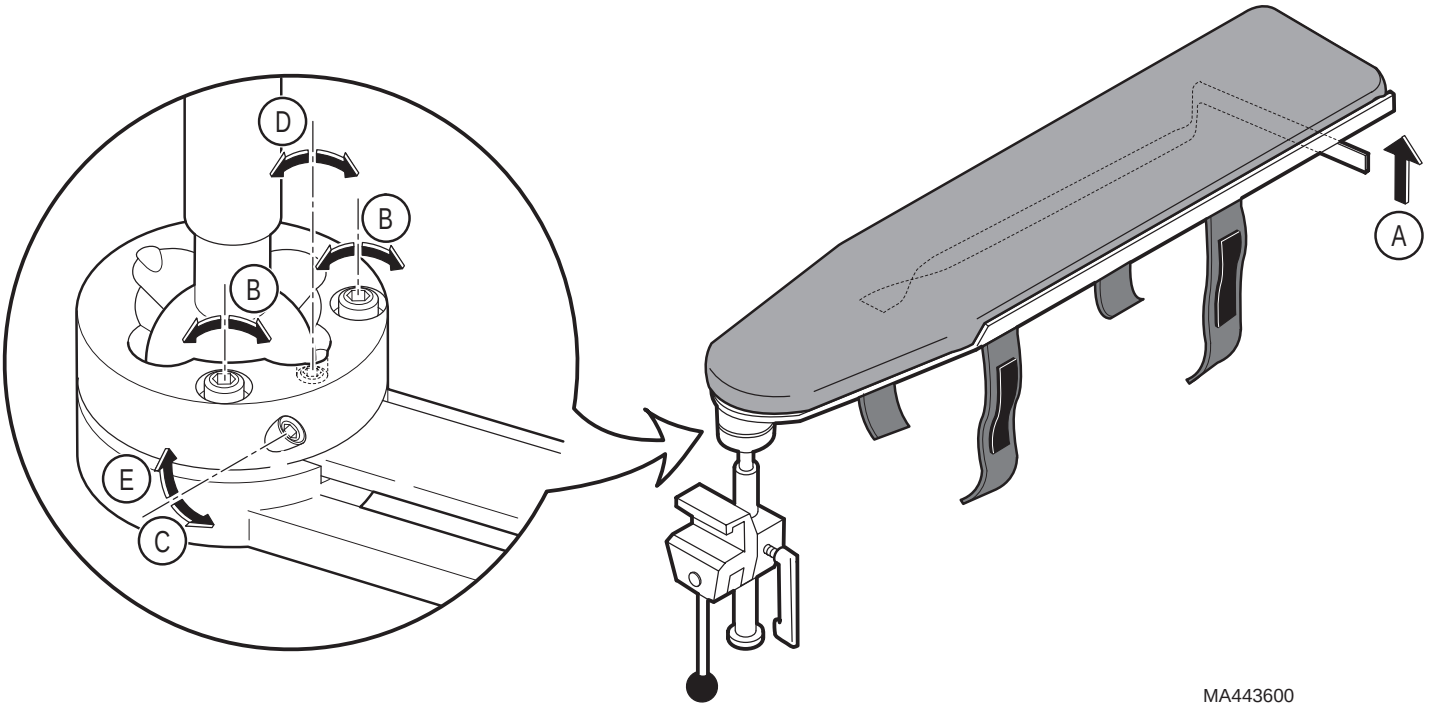

GERÄTE-WARNUNG
Es ist u. U. von Zeit zu Zeit eine Einstellung der Verriegelung erforderlich. Einen 3 mm Innensechskantschlüssel verwenden.

A. Darauf achen, daß der Griff eine Bewegungsfreiheit von 3,2 mm (1/8 in.) bis 4,8 mm (3/16 in.) hat (der Bereich, in dem sich der Griff bewegen läßt, ohne entriegelt zu werden).

HINWEIS
Wenn sich die Bewegungsfreiheit des Griffs nicht in diesem Bereich bewegt, folgende Schritte ausführen.

Festziehen bzw. Lösen der Armablage:

B. Beide Schrauben um eine 1/8 bis 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen, um die Armablage festzuziehen oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie zu lösen.
C. Die Sicherungsschraube lockern.
D. Die Stellschraube im bzw. gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die gewünschte Bewegungsfreiheit des Griffs erreicht ist.
E. Die Sicherungsschraube festziehen.

© Midmark Corporation - 1998